

**測定記録支援システム BLuE
iPadOS 版 DCL31DRBT
ユーザーズマニュアル**

第2版

令和 4 年 10 月 24 日

株式会社アネステック

目次

1 概要	1
2 動作条件	1
3 システム仕様	1
4 用語説明	2
5 取扱説明	3
5.1 測定を行う (Excel)	3
5.2 測定を行う (PDF)	7
5.3 その他の操作	11
5.3.1 DCL31DRBT の設定.....	11
6 FAQ	13

1 概要

本マニュアルは iPadOS 版 BLuE の特定測定器向けマニュアルです。

本マニュアルでは三和電気計器株式会社 DCL31DRBT の操作方法について説明します。

2 動作条件

当システムは、下記スペックを満たす iPad 上で動作させる事を前提とします。

ハード	iPad 5 以降
	その他の動作条件は当該 iPad の動作条件に準じます。

3 システム仕様

当システムは、下記環境で動作させる事を前提とします。

OS	iPadOS 14.8 以降
Excel バージョン	Excel for iPad 2.42 以降 (以下、Excel と表記)
PDF アプリケーション	BLuE PDF Editor (以下、PDFEditor と表記)
通信方式	Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 以降

4 用語説明

本書で使用する用語の説明です。

- タップ
指1本で画面に触れすぐに離すジェスチャ。リンクの移動やボタンの押し上げなどよく使われる基本動作。
- ダブルタップ
短い時間でタップを2回行うジェスチャ。
- ロングタップ
タップで画面に触れている時間を長くしたジェスチャ。
- ドラッグ
タップ/ロングタップで画面に触れたのち指を移動させるジェスチャ。持って動かすイメージ。
- スワイプ
画面上で指を移動させてから離すジェスチャ。払うイメージ。
- ピンチイン/ピンチアウト
画面に2本の指で触れ、2本の間隔を近づけるとピンチイン、2本の間隔を離すとピンチアウト。
- ドック
iPadOSで最近使ったアプリ、登録したアプリを簡単に呼び出すための機能。ホーム画面で画面下に表示されている。
- SlideOver
起動中のアプリの上に別のアプリを小さい画面で起動する手法。複数のアプリを同時に起動できる。
- SplitView
画面を分割し2つのアプリを起動する手法。複数のアプリを同時に起動できる。
- 前面に表示
SlideOver または SplitView の状態でアプリケーションが画面に表示されている状態。

5 取扱説明

5.1 測定を行う (Excel)

共通操作マニュアル(iPad 版)を参照して、測定器との接続まで完了させます。

尚、測定においては Web 版 Excel においても同様の操作となります。

① 測定値取得の開始

接続中の機器が表示されている状態で BLuEApp の開始ボタンをタップすると測定値の取得が開始されます。




② Excel に測定値を反映する

Excel 上の測定値を入力したいセルをタップします。DCL31DRBT のファンクションスイッチを測定したいファンクションに合わせて。後述の設定により BLuEApp のファンクションと DCL31DRBT 本体のファンクションが一致していない場合測定値の出力はできません。

(ア) 自動モード (ファンクション確認が OFF) の場合

DCL31DRBT 本体のファンクションスイッチを操作すると BLuEApp のファンクションが自動で変更されます。ファンクションが正しいことを確認後、セル反映ボタンをタップすると測定値が選択しているセルに反映されます。

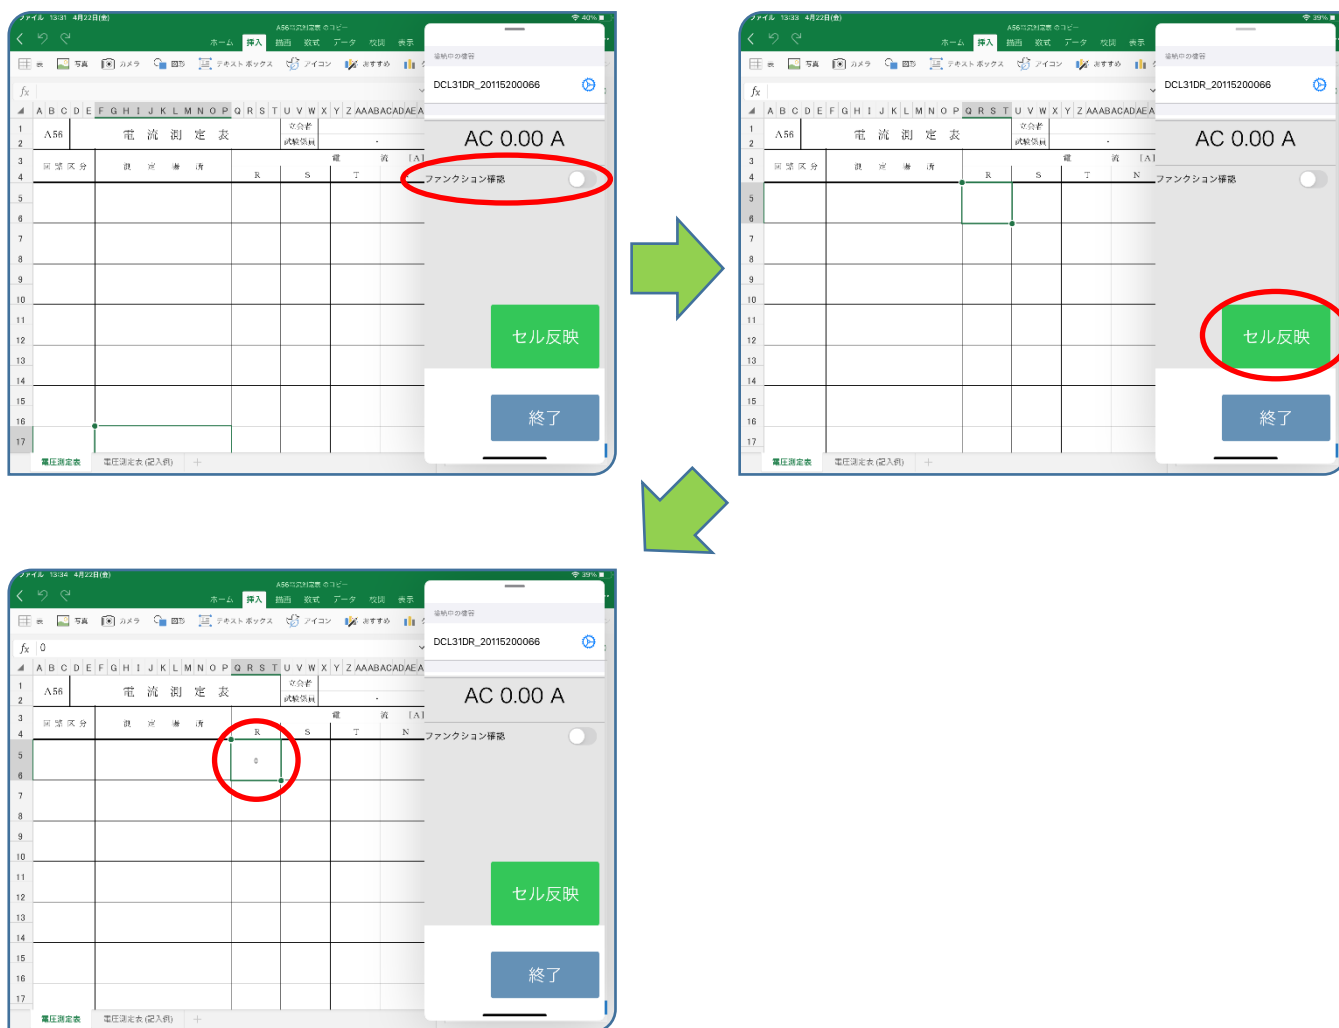


(イ) 手動モード（ファンクション確認が ON）の場合

DCL31DRBT 本体のファンクションと BLuEApp のファンクションが一致していない場合、測定値の出力はできません。BLuEApp のファンクションを DCL31DRBT のファンクションに合わせ測定を行ってください。


a. DCL31DRBT 本体のファンクションスイッチを操作

DCL31DRBT 本体のファンクションスイッチを操作しても BLuEApp のファンクションは変更されません。BLuEApp に表示される測定値は変更後のファンクションに応じた値が表示されます。

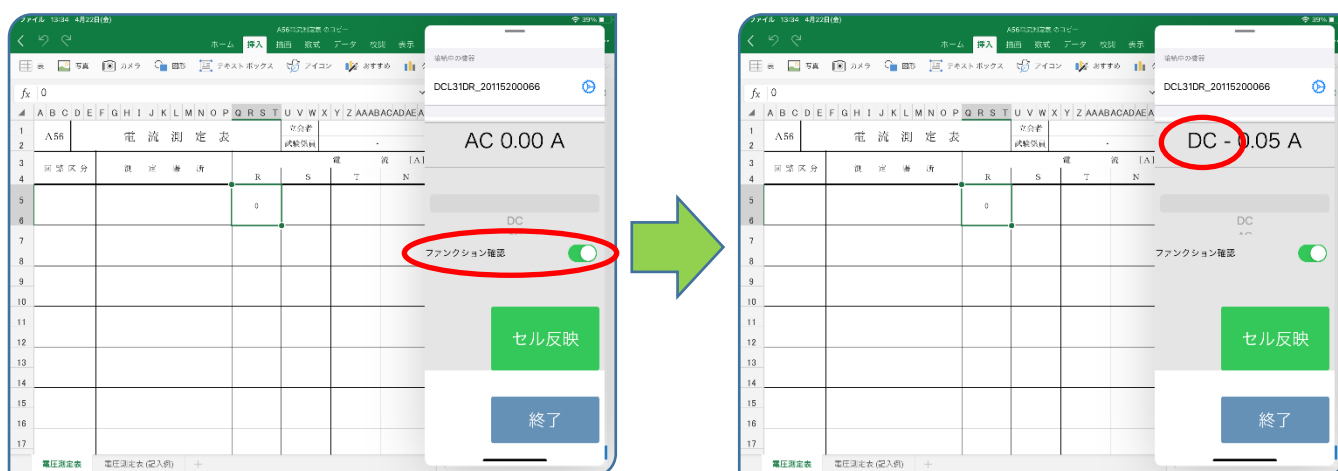


b. BLuEApp のファンクションスイッチを操作

DCL31DRBT のファンクションに合わせて BLuEApp のファンクションを変更します。画面中央のファンクションスイッチを上下にスワイプしファンクションを一致させます。

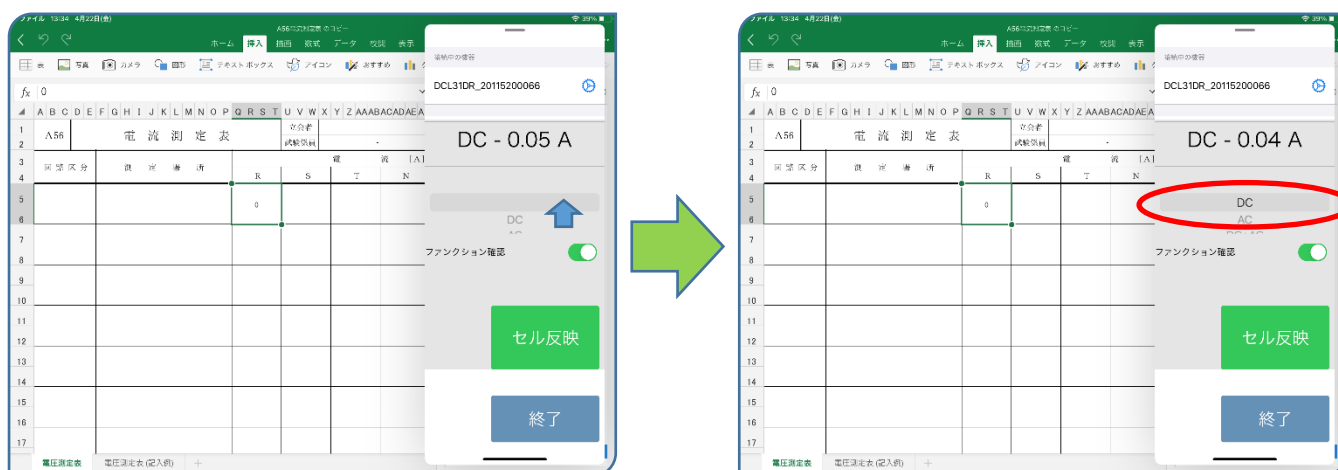


c. 測定値を反映する

ファンクションが一致している状態で、セル反映ボタンをタップすると測定値が選択しているセルに反映されます。

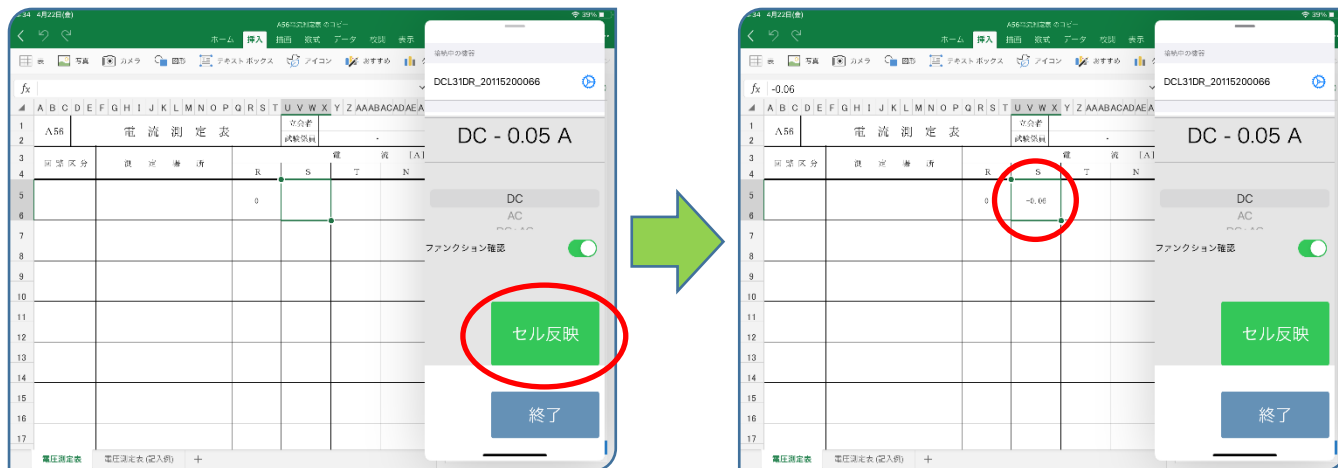

ファンクションが一致していない状態で、セル反映ボタンをタップすると警告が表示されます。ファンクションを一致させ再度測定を行ってください。

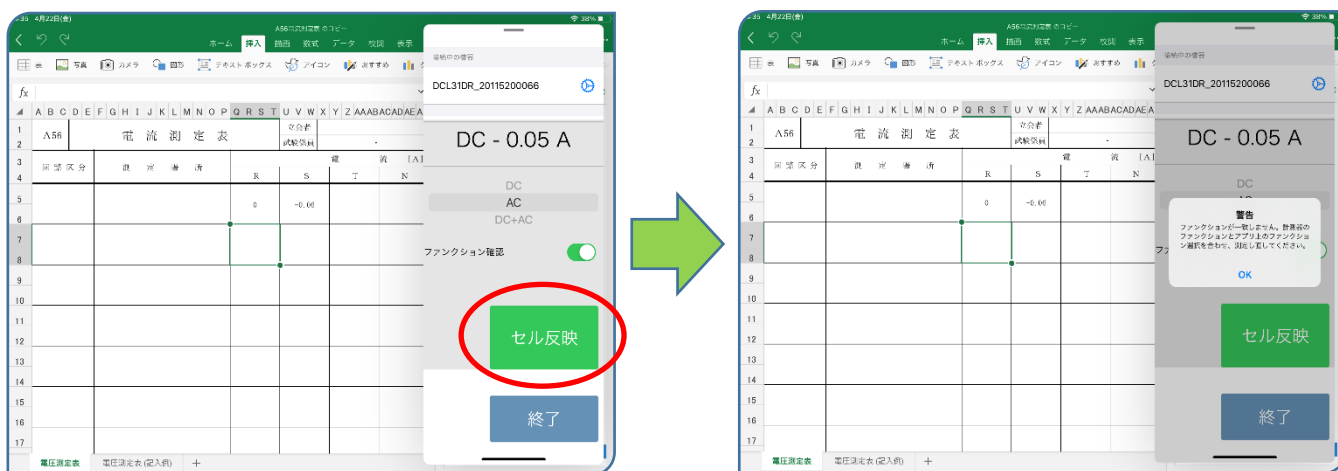

③ 測定値取得の終了


終了ボタンをタップすると測定開始前の画面に戻ります。

5.2 測定を行う (PDF)

共通操作マニュアル(iPad版)を参照して、測定器との接続まで完了させます。

① 測定値取得の開始

接続中の機器が表示されている状態で BLuEApp の開始ボタンをタップすると測定値の取得が開始されます。

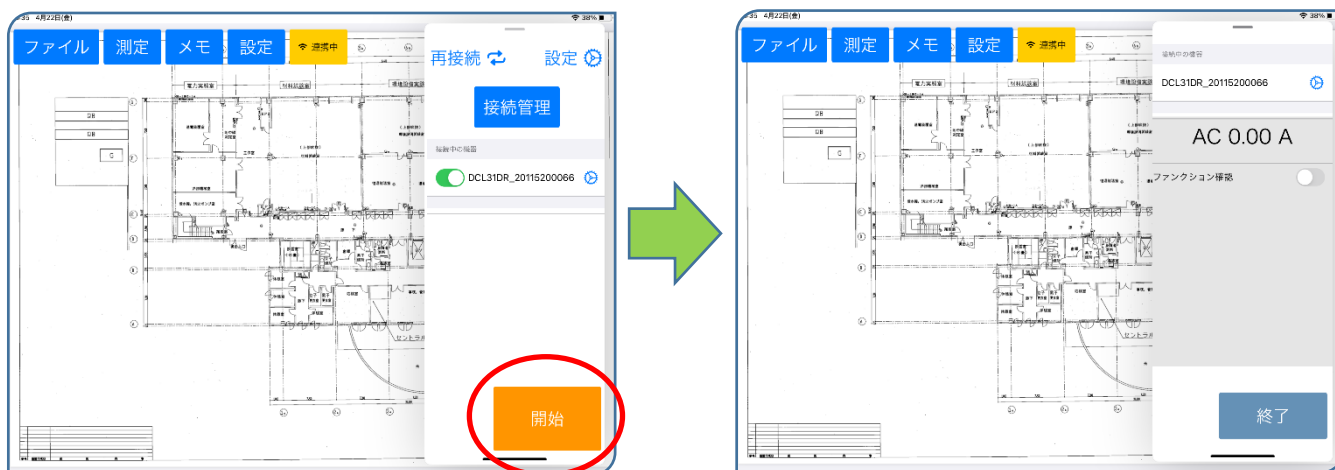


② PDF に測定値を反映する

測定ボタンをタップすると測定モードになります。DCL31DRBT のファンクションスイッチを測定したいファンクションに合わせて。後述の設定により BLuEApp のファンクションと DCL31DRBT 本体のファンクションが一致していない場合測定値の出力はできません。

(ア) 自動モード (ファンクション確認が OFF) の場合

DCL31DRBT 本体のファンクションスイッチを操作すると BLuEApp のファンクションが自動で変更されます。ファンクションが正しいことを確認し PDF 上の測定ポイントをタップします。測定値が PDF 上に反映されます。

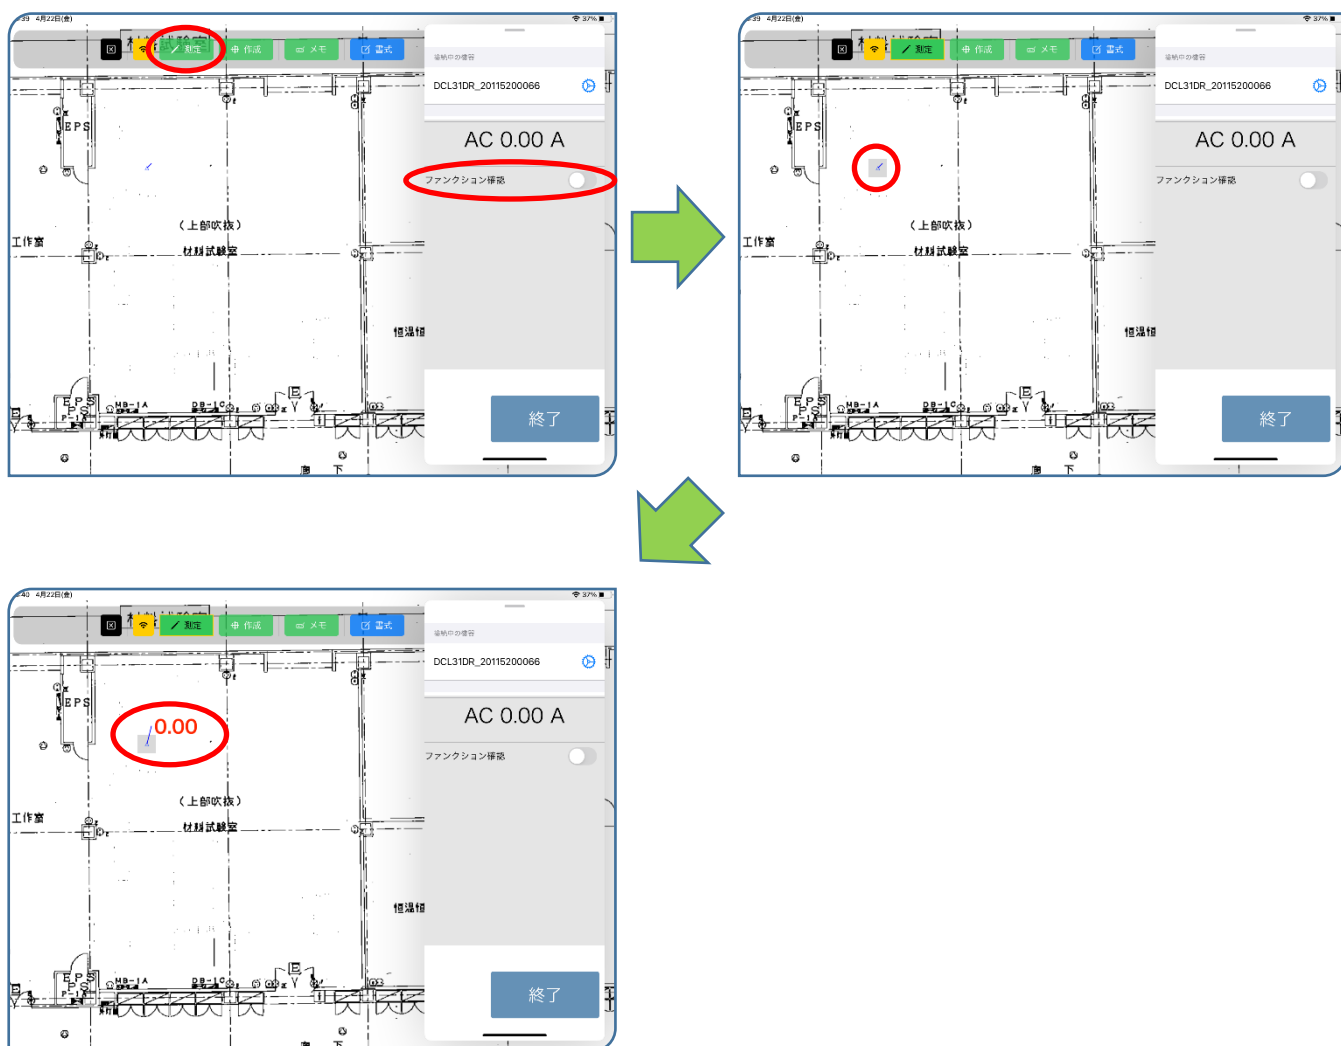

(イ) 手動モード（ファンクション確認が ON）の場合

DCL31DRBT 本体のファンクションと BLuEApp のファンクションが一致していない場合、測定値の出力はできません。BLuEApp のファンクションを DCL31DRBT のファンクションに合わせ測定を行ってください。

a. DCL31DRBT 本体のファンクションスイッチを操作

DCL31DRBT 本体のファンクションスイッチを操作しても BLuEApp のファンクションは変更されません。BLuEApp に表示される測定値は変更後のファンクションに応じた値が表示されます。



b. BLuEApp のファンクションスイッチを操作

DCL31DRBT のファンクションに合わせて BLuEApp のファンクションを変更します。画面中央のファンクションスイッチを上下にスワイプしファンクションを一致させます。



c. 測定値を反映する

ファンクションが一致している状態で、測定ポイントをタップすると測定値が測定ポイントに反映されます。



ファンクションが一致していない状態で、測定ポイントをタップすると警告が表示されます。ファンクションを一致させ再度測定を行ってください。



③ 測定値取得の終了

終了ボタンをタップすると測定開始前の画面に戻ります。

5.3 その他の操作


5.3.1 DCL31DRBT の設定

メイン画面の設定ボタンを押すと各種設定が可能です。



① ファンクション確認

ファンクション確認を ON にすると、次回 BLUeApp を起動した際のファンクション確認
トグルがデフォルトで ON の状態となります。

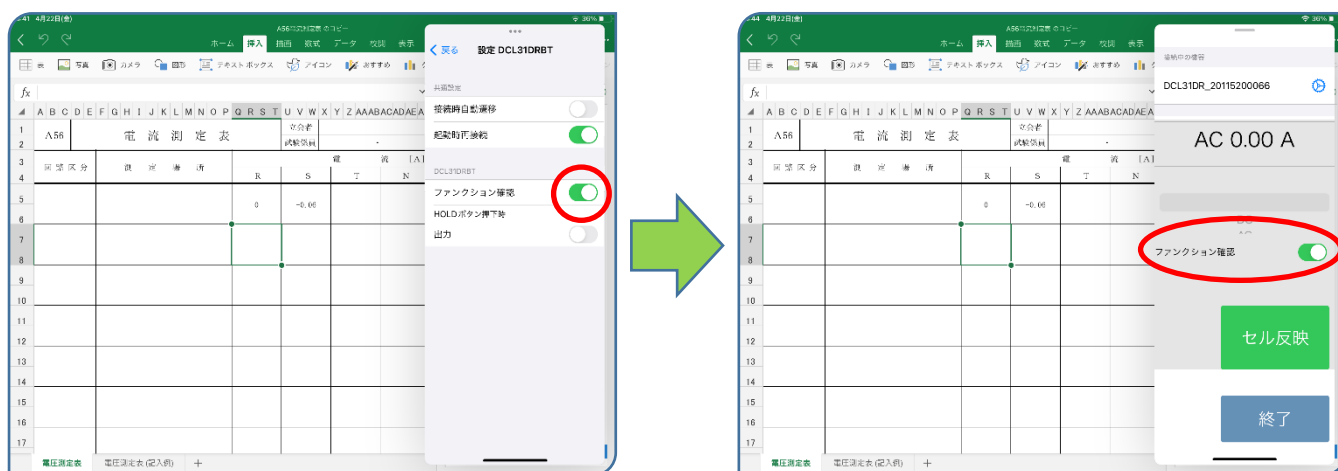

② HOLD ボタン押下時出力


(ア) ON の場合

クランプメーターの HOLD ボタンを押下して測定値をホールドすると、Excel または BLuE PDF Editor に測定値が反映されます。

(イ) OFF の場合

クランプメーターの HOLD ボタンを押下して測定値をホールドしても、Excel または BLuE PDF Editor に測定値が反映されません。

詳細は「5.1② Excel に測定値を反映する」「5.2② PDF に測定値を反映する」を参照してください。

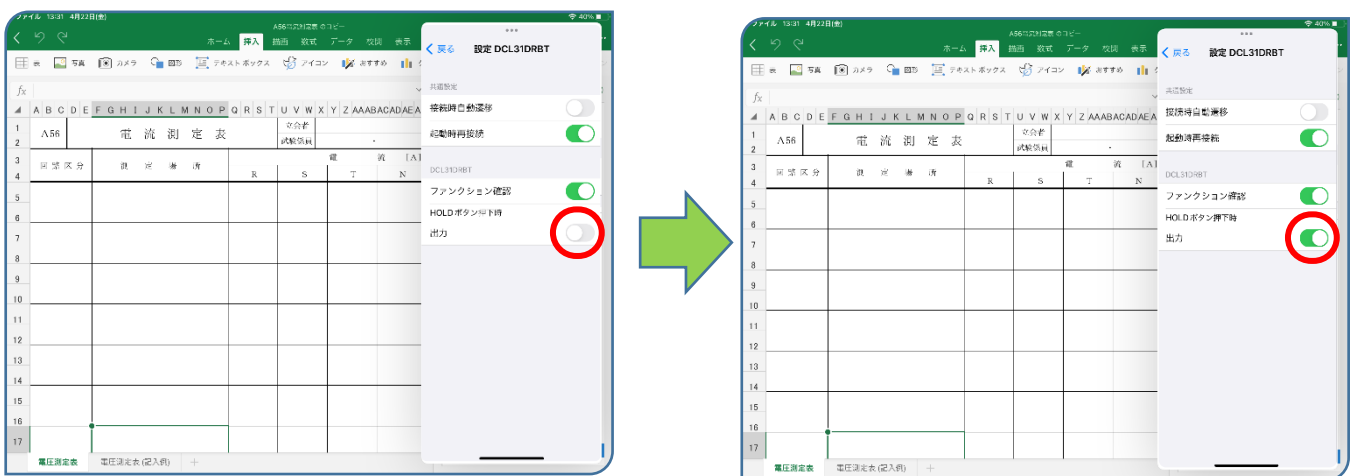

6 FAQ

システム仕様

Q. iPhone シリーズで動作しますか？

A. iPhone シリーズでは動作しません。社給 iPad のみとなります。

また、OS のバージョンは「iPadOS14.6」以降を使用してください。

Q. BLuEApp が前面に表示されていない状態で測定値を出力できますか？

A. BLuEApp が前面に表示されていない状態で測定値を出力することはできません。

測定器

Q. 測定器の使い方を知りたい。

A. 測定器の説明書をご確認ください。

Excel

Q. Excel の基本的な使い方を知りたい。

A. Microsoft のヘルプ、サポートをご確認ください。